Синус-лифинг с набором OneCAS KIT

OneCas KIT

- Выберите типоразмер и положение имплантата в ходе цифрового планирования
- Зафиксируйте хирургический шаблон OneGuide в полости рта и выполните препарирование и установку имплантата в точном соответствии с планом лечения
- Проведите синус-лифтинг без риска перфорации мембраны Шнейдера с помощью набора CAS KIT
- Простой хирургический протокол позволяет работать максимально быстро и эффективно

Синус-лифтинг с помощью набора CAS KIT исключает перфорацию мембраны Шнейдера

- Сверла CAS имеют закругленный кончик, что предотвращает перфорацию мембраны.



Безопасный закругленный кончик сверла



Предотвращает перфорацию мембраны

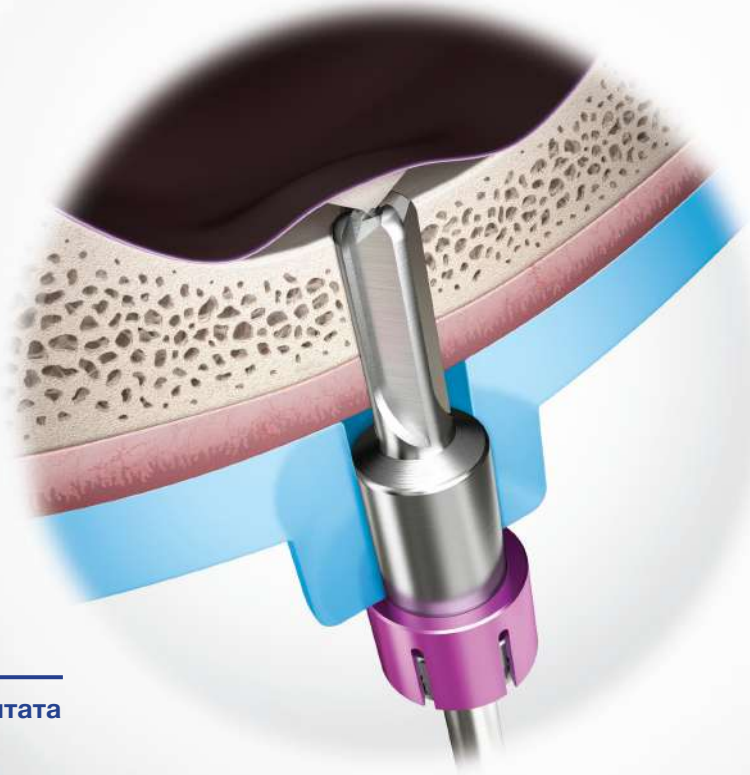

Выберите типоразмер и положение имплантата в ходе цифрового планирования

- Определите оптимальное положение и типоразмер имплантатов на основе данных компьютерной томографии и сканирования
- Изготовьте шаблон OneGuide для установки имплантатов в соответствии с результатами цифрового планирования



Выберите типоразмер и положение имплантата в компьютерной программе

Изготовьте хирургический шаблон OneGuide для установки имплантатов в сочетании с синус-лифтингом

Хирургический шаблон OneGuide обеспечивает точное препарирование ложа и безопасную имплантацию

Препарирование ложа

Гидравлический синус-лифтинг

Введение костного материала

Установка имплантата

Набор OneCAS KIT и его основные компоненты

Втулка шаблона Ø5 .1 — **Левая сторона:** Для имплантатов Ø 4/4,5

Втулка шаблона Ø5.8 — **Правая сторона:** Для имплантатов Ø 5

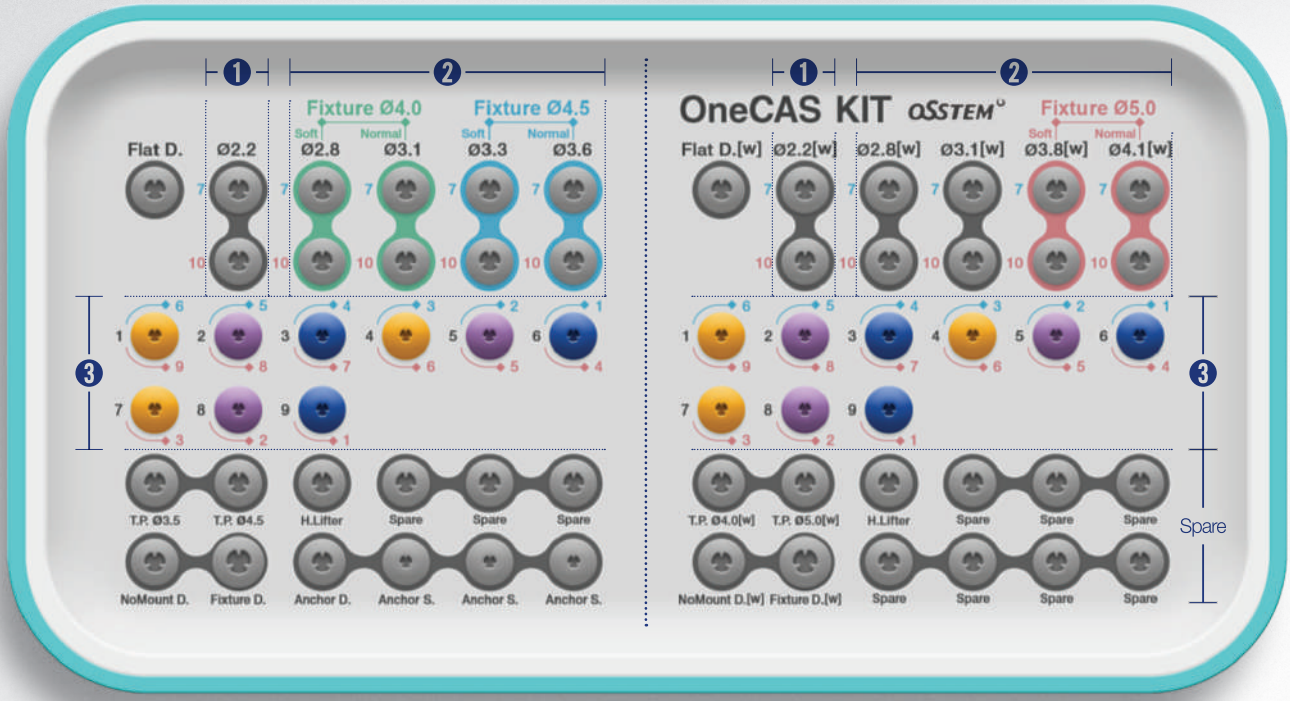

1 Пилотное сверло (1200 об/мин)

- Длина: 7/10 мм – 2 вида
- Диаметра втулки шаблона: 5,1/5,8 – два вида
- Наденьте стоппер перед сверлением

2 Сверло OneCAS (800 об/мин)

- Длина: 7/10 мм – 2 вида
- Диаметра втулки шаблона: 5,1/5,8 – два вида
- Наденьте стоппер перед сверлением

3 Стоппер

- Высота: 1–9 мм – 9 видов
- Диаметр втулки шаблона: 5,1/5,8 – два вида

Параметры стоппера



Глубина сверления при использовании сверла длиной 7 мм

Глубина сверления при использовании сверла длиной 10 мм

Глубина введения глубиномера при использовании со стоппером

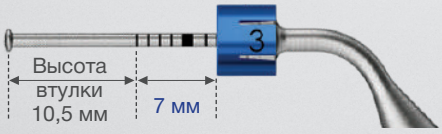

4 Другие инструменты

Устройство для гидравлического подъема мембраны

Лопатка для внесения костного материала

Уплотнитель кости

Хирургический протокол при использовании набора OneCAS KIT

Высота кости менее 7 мм

Пример: высота кости 4 мм, мягкая кость, имплантат 4 мм x 8,5 мм

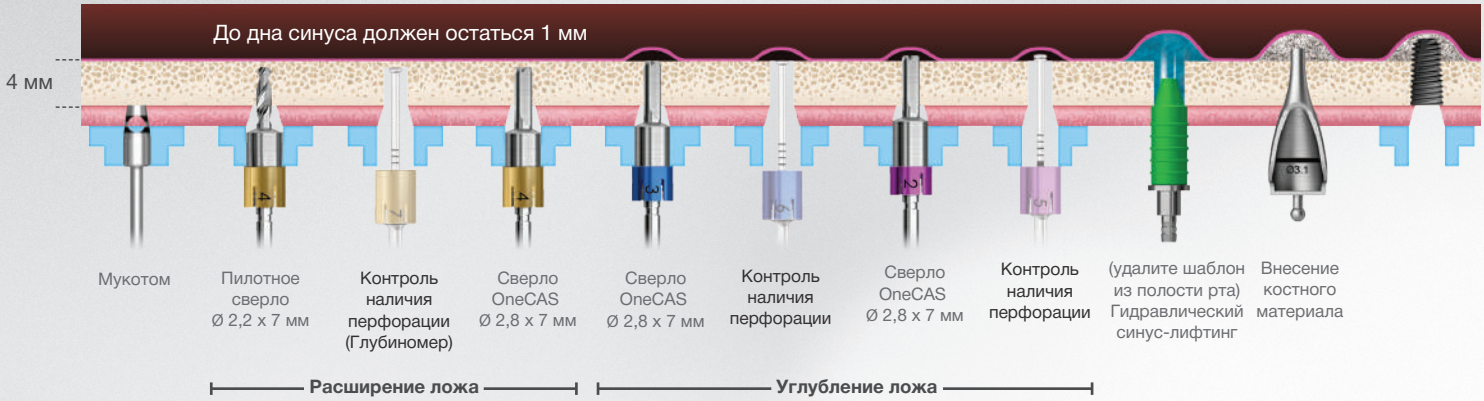

Высота кости более 7 мм, но менее 9 мм

Пример: высота кости 8 мм, мягкая кость, имплантат 4,5 мм x 10 мм

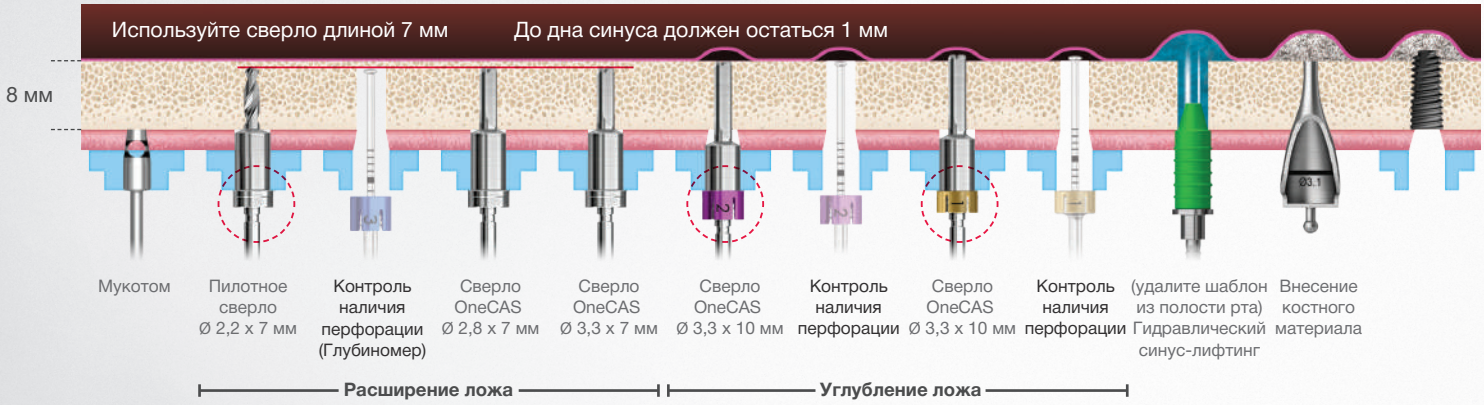

Высота кости более 9 мм, но менее 10 мм

Пример: высота кости 9 мм, мягкая кость, имплантат 5 мм x 10 мм (втулка в шаблоне: Ø 5,8 мм (W))

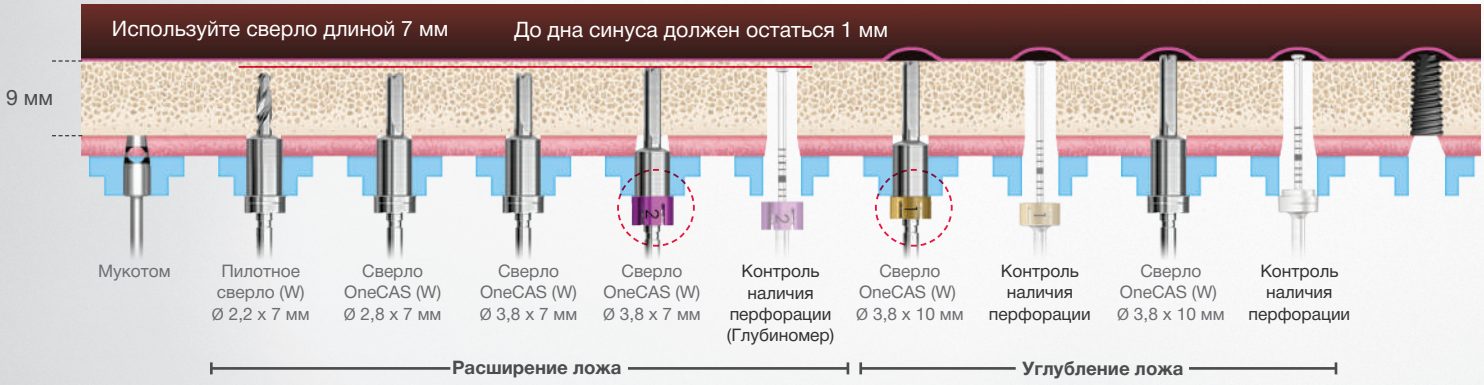

Протокол расширения ложа имплантата при использовании набора OneCAS KIT

Сверло	Кость	2,2 мм	2,8 мм	3,1 мм	3,3 мм	3,6 мм	3,8 мм (W)	4,1 мм (W)
Ø4.0	Мягкая	●	●					
	Нормальная	●		●				
Ø4.5	Мягкая	●	●		●			
	Нормальная	●		●		●		
Ø5.0	Мягкая	●	●				●	
	Нормальная	●		●				●

OneCAS KIT

Набор для проведения закрытого синус-лифтинга по цифровому протоколу с применением хирургического шаблона

Область применения TSIII TSIV ETIII SSIII

Лопатка для внесения костного трансплантата
OCBCH32, OCBCH37W

Глубиномер OneCAS
OCDG

Глубиномер OneCAS (W)
OCDGW

Инструмент для внесения костного трансплантата
OCBCS30

Трубки силиконовые 3 шт
SNMT
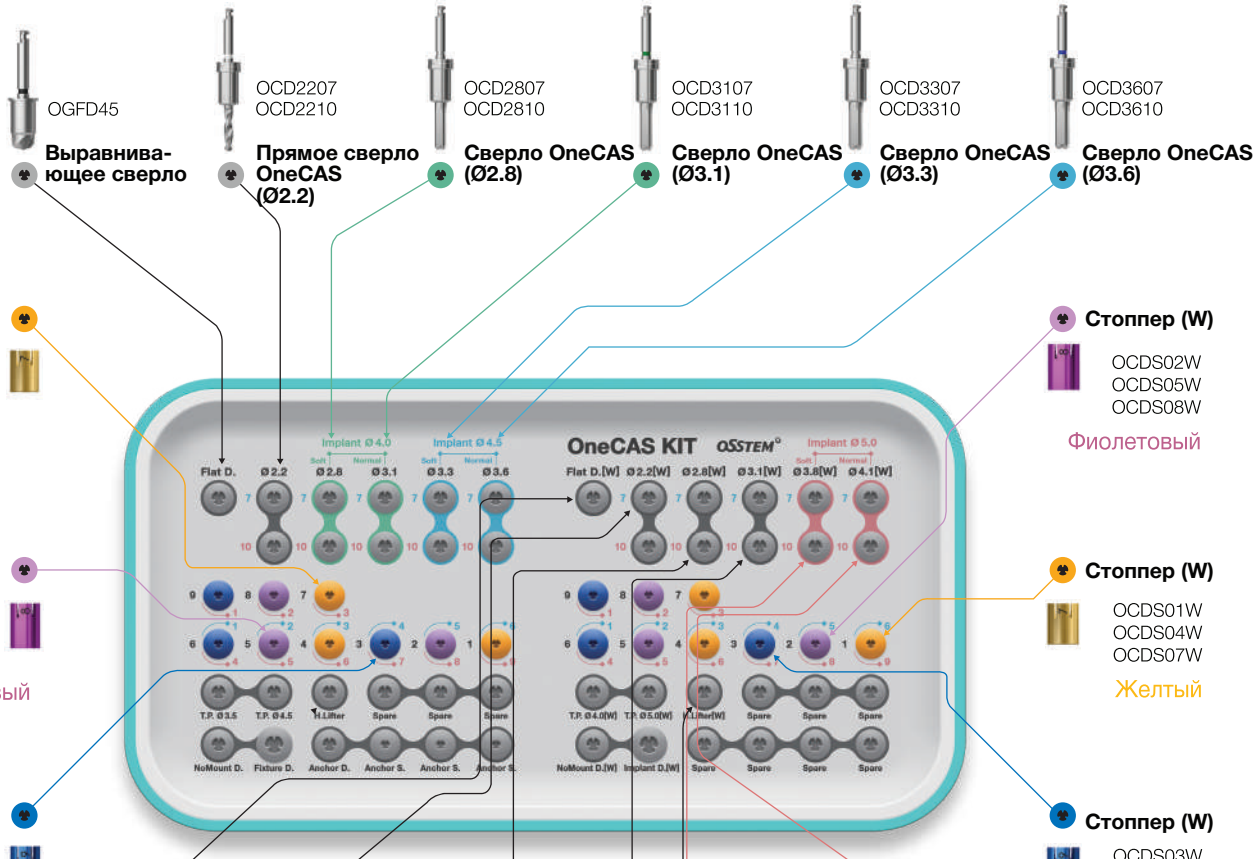
Уплотнитель кости
SNBC1114